

2024年4月吉日

お客様 各位

日本ハム株式会社
中央研究所 ヘルスサポート課

食中毒菌簡易迅速検査キット「NHイムノクロマトIIシリーズ」発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度食中毒菌簡易迅速検査キット「NHイムノクロマトシリーズ」の後継品として「NHイムノクロマトIIシリーズ」を発売いたします。発売時期および現行品との変更点について、下記の通りご案内申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 後継品商品名：

- ・NHイムノクロマトII O157
- ・NHイムノクロマトII O111
- ・NHイムノクロマトII O26
- ・NHイムノクロマトII VT1/2

2. 後継品発売時期：2024年6月から順次

* 現行品は在庫が無くなり次第、販売を終了いたします。

3. リニューアル内容：

以下の項目を変更しております。詳細は別紙をご確認ください。

記載した項目以外は変更ありませんので、現行品と同様にお使いいただけます。

| 変更箇所 | 現行品 NHイムノクロマトシリーズ | 後継品 NHイムノクロマトIIシリーズ |
|-------------|--------------------------------|------------------------|
| テストストリップサイズ | 60mm×5mm | 80mm×5mm |
| 外箱サイズ | 110mm×65mm×40mm | 57mm×38mm×128mm |
| 包装・包材 | 2テスト/袋、アルミ蒸着 | 1テスト/袋、透明蒸着フィルム |
| 構成品* | テストストリップ(2本×10) ユニパック、取扱説明書 | テストストリップ(1本×20)* |
| 保存温度 | 冷蔵 | 2~30°C |
| AOAC認証の有無 | 有(O157のみ)** | なし |


*：後継品は取扱説明書を同梱していません。キット外箱のQRコードからご確認ください。

**：現行品(AOAC認証付)の最終ロットの使用期限は2024年12月となります。

以上

(別紙) テストストリップサイズ、包装形態の変更詳細

主な変更点1：テストストリップサイズの変更

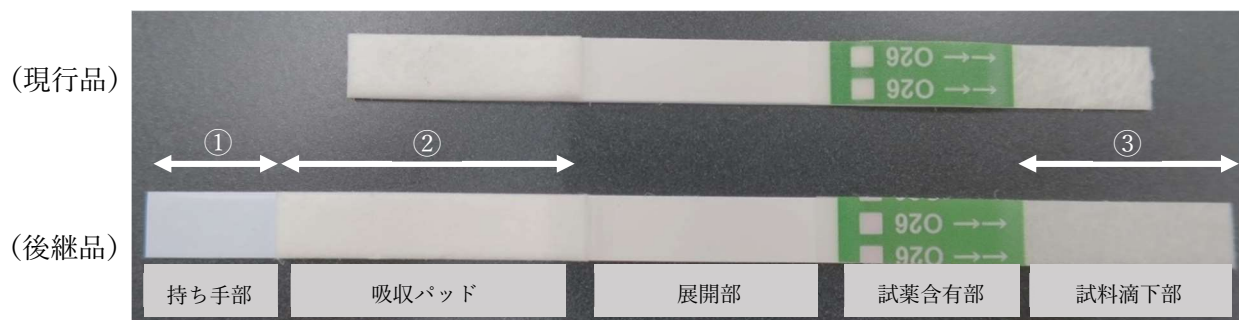

変更点1-① 吸収パッド上部に持ち手部を設置

→テストストリップの持ち運びが便利になり、検体名等を記載できるスペースを設けました。

変更点1-② 吸収パッドのサイズ変更

→吸収パッドを長く、厚くし、検体液を吸い取りやすいように設計しました。

変更点1-③ 試料滴下部のサイズ変更

→試料滴下部面積を大きくし、試料を滴下しやすいように設計しました。

主な変更点2：包装形態の変更

(現行品)



(後継品)

(オモテ)



(ウラ)

変更点2-① テストストリップ包装を透明蒸着フィルムに変更

→直射日光をさけて2~30°Cで保存してください。

テストストリップ包装を外箱から出して保存する場合には遮光してください。

変更点2-② 個包装×20テスト入りに変更

→内容量は変わらず個包装となったため、お客様の使用頻度に合わせてお使いいただけます。

以上